



Dott. BRUNO CATARA
 NUCLEO CHIMICO MEDITERRANEO
 Laboratorio Accreditato Accredia n. 0898
 Elenco prove accreditate sul sito www.accredia.it
 Laboratorio iscritto nell'Elenco Regionale dei Laboratori
 ai fini dell'Autocontrollo n. 2012/CT/009
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
 IIRG-MRA



Rapporto di Prova N. 6839/19


(139) Reg. CEE N. 2568/91 e succ. modifiche e integrazioni

Certificato di analisi chimiche valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n.842
 art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 D.M. 21/6/78 art.8 c. 3 D.M. 25/3/1986 -
 Per le prestazioni analitiche deve essere rilasciato un certificato firmato dal chimico.

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile Tecnico e di Laboratorio
 Dott. Chimico Bruno Catara

Firmato digitalmente da
 Dott.
 Bruno Attilio Catara
 CHIMICO
 O = Ordine degli Ingegneri di Catania
 C = IT

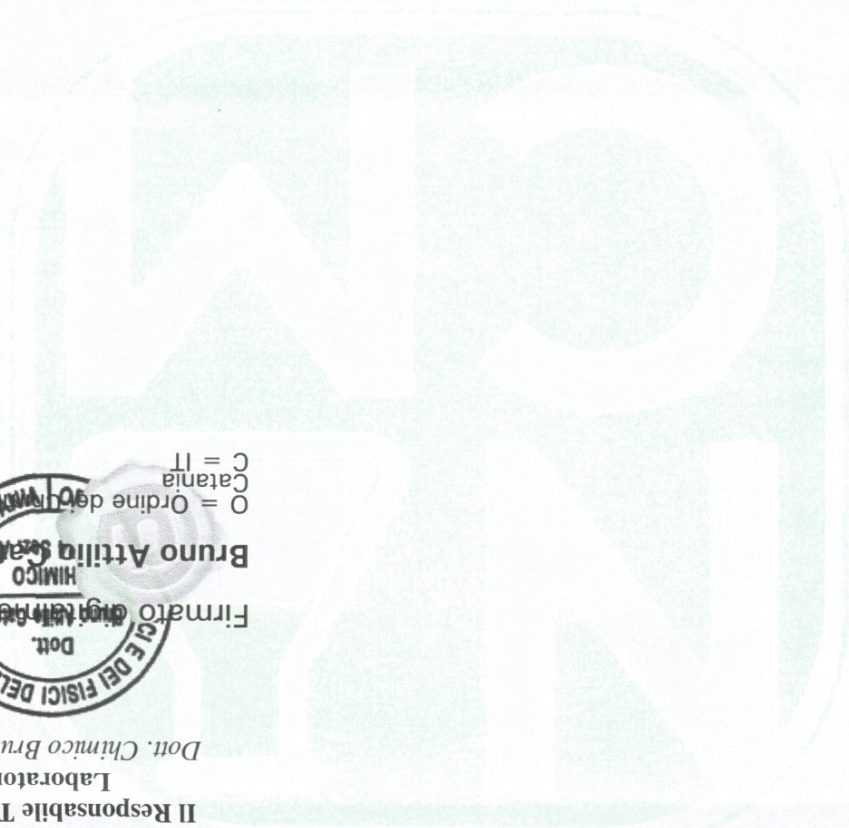

LAB N° 0898 L